



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

140/1/26/E/IPSR

KEPADA :



- | | | |
|----------------|------------|---------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Jesisca | 5. Aris |
| 2. Pak Syaiful | 4. Dika | |

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-01-12 08:17:19	134/1/26	Rabu, 14 Januari 2026	Radiologi

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
X Ray	Philips SRO33100 (DD)	-	266678

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
1. DD tidak bisa digunakan expose , hasil tidak muncul. 2. PACS tidak bisa	Melakukan pengecekan pada jaringan internet pacs tidak bisa, detektor xray tidak connect, prunt dengan mobile WDR tidak connect setelah diping alat error communication dengan internet setelah dicek oleh it switch hub rusak dan digantikan dengan milik it alat sudah normal bisa berfungsi kembali	sudah normal

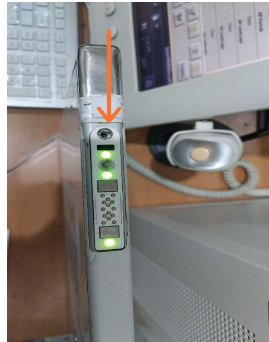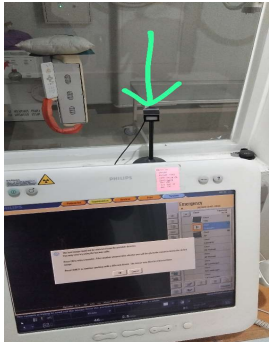

SPAREPART

- | | |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Bu Nova

Jesisca

Dika

Aris

Penerima Pekerjaan

Franky

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Ka. IPSRS

Alivia Ayu Ninditya Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016