



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

286/1/26/E/IPSR

KEPADA :



1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Dika
4. Aris
5. Jesisca

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-01-30 15:54:11	326/1/26	Jum'at, 30 Januari 2026	IGD

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
ECG	GE (MAC 2000)	-	STX 22090139PA

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
hasil print ecg keluar 2 halaman. 1 kertas kosong dan 1 hasil ecg	compare dan melihat setting pada ecg di ruang icvcu	compare dan melihat setting pada ecg di ruang icvcu
	pengecekan menggunakan phantom ecg dengan lead normal hasil tidak keluar dari kertas	pengecekan menggunakan phantom ecg dengan lead normal hasil tidak keluar dari kertas
	pengecekan menggunakan sadapan manusia report tidak keluar dari 1 kertas	pengecekan menggunakan sadapan manusia report tidak keluar dari 1 kertas
	terjadinya lebih dari 1 kertas karena kesimpulan pemeriksaan manusia abnormal dan membutuhkan lebih dari 1 kertas.	terjadinya lebih dari 1 kertas karena kesimpulan pemeriksaan manusia abnormal dan membutuhkan lebih dari 1 kertas.
	setting ecg disamakan dengan setting ecg icvcu	setting ecg disamakan dengan setting ecg icvcu
	menurut pendapat user sendiri kertas keluar sebelum lead . dengan asumsi tersebut teknisi elektromedis menyatakan bahwa hal tersebut bisa terjadi karena baru saja mengganti kertas ecg atau tempat kertas dibuka tutup sebelumnya dan posisi kertas tidak sesuai dengan yang seharusnya sehingga print lead tidak bisa dari halaman 1 namun ecg menyesuaikan dulu dengan letak awal kertas	menurut pendapat user sendiri kertas keluar sebelum lead . dengan asumsi tersebut teknisi elektromedis menyatakan bahwa hal tersebut bisa terjadi karena baru saja mengganti kertas ecg atau tempat kertas dibuka tutup sebelumnya dan posisi kertas tidak sesuai dengan yang seharusnya sehingga print lead tidak bisa dari halaman 1 namun ecg menyesuaikan dulu dengan letak awal kertas

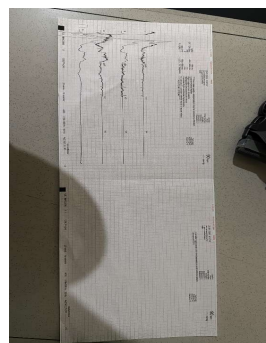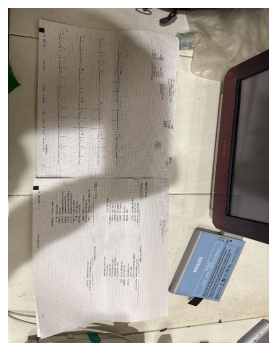


SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana



Bu Nova



Dika



Aris



Jesisca


Penerima Pekerjaan



Kristyan


bag. IPSRS RSUD SLG

Admin



Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS



Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016